

 Додатне информације и појашњења	Ознака формулара QF-G-029
Број страна 1/3	

JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD
 Ulica Balkanska 13
 Broj: 12.01. *555222/2-18*
 Beograd, 29.11.2018. god

Na osnovu člana 54. i 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za javnu nabavku dobara: Ležajevi I hilzne, nav I ostalo, 4000/0304-4/2018, na zahtev zainteresovanog lica, daje

**DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA
U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE
Br. 1.**

Pet i više dana pre isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, zainteresovano lice je u pisanom obliku od naručioca tražilo dodatne informacije odnosno pojašnjenja a Naručilac u roku od tri dana od dana prijema zahteva objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca, sledeće informacije, odnosno pojašnjenja:

PITANJE 1: Na str.4 KD u delu 3.TEHNIČKA SPECIFIKACIJA u tački 3.2 “Standardi, tehničke karakteristike I isporuka kotrljajnih ležajeva” između ostalog stoji:

- na str.4 u tač.8 šumnost i vibracije ležaja navedeno je: Najviši dozvoljeni nivo vibracija za bačvaste ležajeve **prema tabeli iz Pravilnika** o tehničkim I drugim zahtevima za kotrljajne ležajeve **br.110-00-7/2015 od 24.11.2016. (prilog 1)**
- na str.4 navedeno je: isporuku kotrljajnih ležajeva izvršiti **u skladu sa Pravilnikom** o tehničkim I drugim zahtevima za kotrljajne ležajeve **br.110-00-7/2015-07 od 24.11.2016. (prilog 1)**
- na str.5 u okviru Napomene navedeno je: Osnova za eventualnu proveru kvaliteta ležaja je **procedura Mašinskog fakulteta Beograd broj 337/1 od 25.11.2005. godine (prilog 2)** na osnovu koje će biti urađen Plan kontrolisanja ležaja.

Ni jedan od gore navedenih priloga: prilog 1 i prilog 2 Naručilac nije objavio u okviru KD a pri tome je njima definisao tehničke zahteve u okviru Tehničke specifikacije predmetne JN koje Ponuđači moraju da ispune.

Molimo Naručioca da izvrši izmenu KD tako što će nedostajuće Priloge 1 i 2 (gore navedene) objaviti kao sastavni deo predmetne KD. Napominjemo Naručiocu da je VAŽEĆI Pravilnik o tehničkim I drugim zahtevima za kotrljajne ležajeve (izmenjeno i dopunjeno izdanje u odnosu na ovde pomenuti **br.110-00-7/2015-07 od 24.11.2016**) objavljen u Službenom Glasniku Republike Srbije broj 66/2018, pa se na njega i treba pozvati u konkursnoj dokumentaciji i Prilog objaviti u skladu sa tim.

Napominjemo Naručiocu da je dužan da konkursnu dokumentaciju pripremi u skladu sa čl.70 I čl.71 ZJN tj da jasno I precizno definiše Tehničku specifikaciju kako bi Ponuđači mogli da dostave prihvatljive ponude u skladu sa čl.61 ZJN.

ODGOVOR 1: Naručilac će izvršiti izmenu i dopunu konkursne dokumentacije u skladu sa postavljenim pitanjem.



Додатне информације и појашњења

Ознака формулара

QF-G-029

Број страна

2/3

PITANJE 2: Na str.4 KD u delu 3.TEHNIČKA SPECIFIKACIJA u tački 3.2 "Standardi, tehničke karakteristike i isporuka kotrljajnih ležajeva" tehnički zahtevi u pogledu dimezija i radijalnog unutrašnjeg zazora, u tačkama 4. i 6.. definisani su DIN standardima.

U drugom stavu iste tačke 3.2 se zahteva da se isporuka ležaja izvrši u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje.

Napominjemo Naručiocu da su uslovi isporuke (stavljanja na tržište Republike Srbije) u pogledu tehničkih zahteva (dimenzije, radijalni unutrašnji zazor) kotrljajnih ležajeva po Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima definisana po SRPS ISO i SPRS EN standardima kao i da su sve laboratorije u kojima bi se vršilo eventualno ispitivanje predmetnih ležaja akreditovane za ispitivanja isključivo po SRPS ISO ili SRPS EN standardima i nisu u mogućnosti da vrše ispitivanja i izdaju Izveštaje u skladu sa DIN standardima.


Osim toga, članom 71 stav 6 ZJN je predviđeno da „... ako se tehnički propis poziva na srpski standard, takav standard je obavezan i primenjuje se kao tehnički propis, bez navođenja reči „ili odgovarajući“. S obzirom da je Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje, na koji se Naručilac poziva u zahtevima, zaista tehnički propis, Naručilac je dužan da se, u ovom slučaju, pridržava čl.71 stav 6 ZJN.

U tom smislu molimo Naručioca da zahteve u tačkama 4. i 6. u delu KD 3.2 "Standardi, tehničke karakteristike i isporuka kotrljajnih ležajeva", u pogledu standarda, usaglasi sa gore navedenim zahtevom za isporuku ležaja, kao i sa čl.71 stav 6 ZJN, tj., da umesto DIN standarda navede odgovarajuće SRPS ISO ili SRPS EN standarde (u skladu sa pomenutim Pravilnikom), kako bi svi delovi KD u pogledu tehničkih zahteva bili usaglašeni kako Naručioca čl.70 i 71 ZJN obavezuje i kako bi Ponuđači mogli da dostave prihvatljive ponude u skladu sa čl.61 ZJN.

ODGOVOR 2: Naručilac će izvršiti izmenu i dopunu konkursne dokumentacije u skladu sa postavljenim pitanjem.

PITANJE 3: U partiji 2, na poz.51 u Koloni Naziv zahtevanog dobra tražen je "Kuglični ležaj sa kosim dodirom B7206 E". Molimo Naručioca **da pojasni značenje prefiksa "B"** na traženoj poz.51 partije 2 I na taj način jasno I precizno definiše tehničku specifikaciju kako ga čl.70 I čl.71 ZJN obavezuje I omogući Ponuđačima dostavljanje prihvatljivih ponuda u skladu sa čl.61 ZJN.

ODGOVOR 3: Prefiks „B“ je greškom stavljen ispred oznake ležaja. U tabeli br. 2, na strani 36 u vrsti br. 51, u koloni naziv zahtevanog dobra biće izbrisana oznaku „**B7206 E**“, i umesto nje upisuje se oznaka „**7206 B**“. Prefiks B se odnosi na ugao kontakta od $\alpha=40^\circ$ kod kugličnog ležaja sa kosim dodirom što se može i videti u dole priloženoj skici. Na osnovu datog odgovora Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

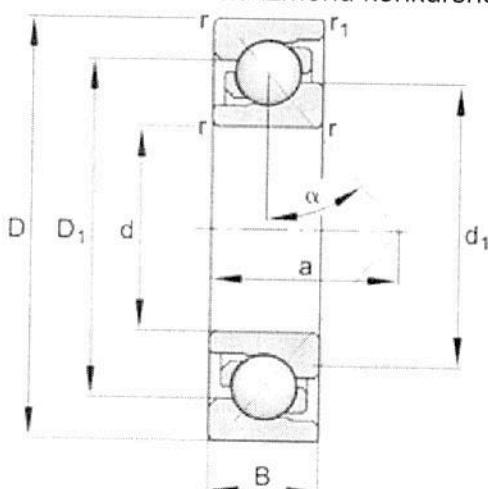



Додатне информације и појашњења

Ознака формулара

QF-G-029

Број страна


3/3

PITANJE 4: U partiji 2, na poz.57, 58 I 59 u Koloni Naziv zahtevanog dobra traženo je redom:

- Na poz.57 "Dvoredi kuglični ležaj sa kosim dodirom 3209 B"
- Na poz.58 "Dvoredi kuglični ležaj sa kosim dodirom 3303 B"
- Na poz.59 "Dvoredi kuglični ležaj sa kosim dodirom 3306 B"

Molimo Naručioca **da pojasni značenje sufiksa "B"** na poz.57, 58 I 59 partije 2 I na taj način jasno I precizno definiše tehničku specifikaciju kako ga čl.70 I čl.71 ZJN obavezuje I omogući Ponuđačima dostavljanje prihvatljivih ponuda u skladu sa čl.61 ZJN.

ODGOVOR 4: Sufiks "B" u oznaci dvoredih kugličnih ležajeva sa kosim dodirom (3209B, 3303B i 3306B) se odnosi na ugao kontakta koji za ovaj tip ležaja iznosi $\alpha=25^\circ$, što se i može videti u dole priloženoj skici.

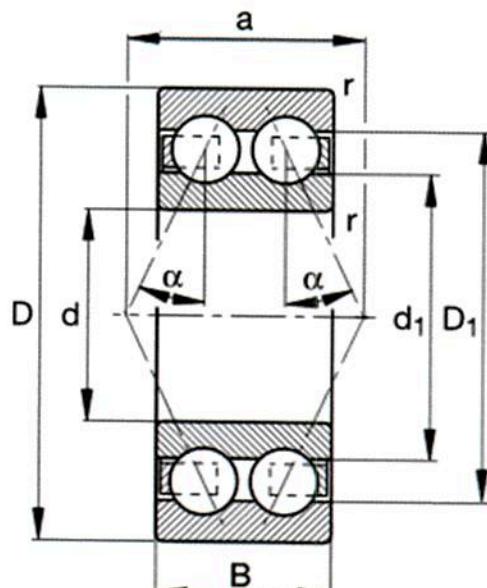

Skica kugličnog ležaja sa kosim dodirom

KOMISIJA ZA
JN/4000/0304-4/2017